

2021年1月7日

診療科長 医局長
病棟医長 外来医長
中央診療施設副部長
看護部長 看護師長
事務部長

殿

検査部 フローサイトメトリー検査室

検査部回報 2021-No.1

フローサイトメトリー検査の測定機器更新に伴う変更について

この度、標記の検査につきまして、測定機器の老朽化により測定機器を変更させていただくことになりましたのでご案内申し上げます。測定機器変更に伴う試薬及び報告範囲の変更はございません。

また、新機器による測定結果と旧機器による測定結果は良好な相関を示しております。詳細な検証データはイントラネットの検査部ホームページをご覧ください。

記











変更日：2020年12月21日（月）受付分より

測定機器

旧機器（変更前）	新機器（変更後）
BD（ベクトン・ディッキンソン）社 FACSCanto II	BD（ベクトン・ディッキンソン）社 FACSLyric

● 測定機器変更に伴う新法と従来法の相関図一覧 （自検査室検討資料）

	従来法	新法
測定機器	BD FACSCanto II	BD FACSLyric
測定方法	フローサイトメトリー法	
単位	百分率（%）	
報告範囲（上限）	100.0%	
報告範囲（下限）	0.0%	
報告桁数	小数点以下1位	

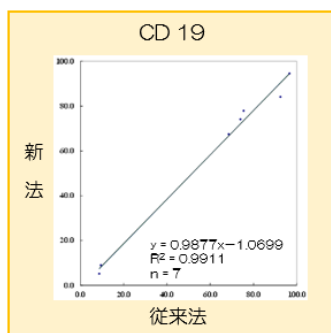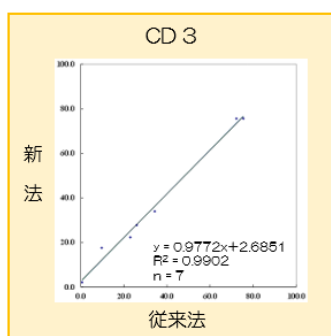

お問い合わせは、検査部 フローサイトメトリー検査室（内線 7412）までお願いします。