

2023年3月2日

診療科長 医局長  
病棟医長 外来医長  
中央診療施設副部長 殿  
看護部長 看護師長  
事務部長

検査部 外注検査作業室

## 検査部回報 2023-No.8


### 外注項目試薬ロット間差のお知らせ

SRL社より、下記項目におきまして現ロット試薬と新ロット試薬のデータ差についてご報告がありましたのでご案内いたします。

記

#### 対象項目：サイトメガロウイルスIgM

試薬販売会社より SRL に納入された試薬の新ロットの検証を行ったところ、現ロットとの相関性に乖離が生じる例が一部存在することが発覚しました（下図）。試薬販売会社内の品質管理規定を満たしていることから、次の製造まで、該当のロットが継続使用されます。つきましては、本件にご留意いただきますようお願いいたします。

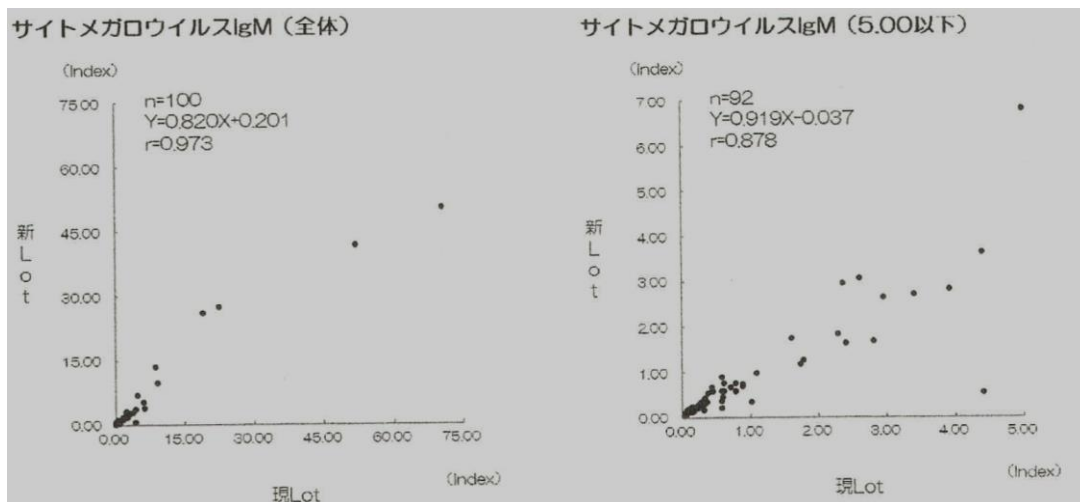

**新ロットによる測定開始日：2023年2月20日（月）依頼分より**

上記についてのお問い合わせは、外注検査作業室（内線7254）までお願い致します。