

2023年6月6日

診療科長 医局長  
病棟医長 外来医長  
中央診療施設副部長 殿  
看護部長 看護師長  
事務部長

検査部 サテライト検査室（生化学）

## 検査部回報 2023-No.22

# 改良試薬への変更のお知らせ


AFPの測定に使用している「エクルーシス試薬 AFPⅡ」およびFT4の測定に使用している「エクルーシス試薬 FT4Ⅲ」が、改良試薬である「エクルーシス試薬 AFPⅡv2」および「エクルーシス試薬 FT4Ⅳ」へ変更となります。改良試薬は、血中ビオチン（ビタミンB7）許容濃度の上限が拡大されています。また、「エクルーシス試薬 FT4Ⅳ」は、使用抗体が【現行試薬：ヒツジポリクローナル抗体】から【改良試薬：ウサギモノクローナル抗体】に変更になります。

現行試薬と改良試薬は良好な相関を示しており、ご依頼方法や結果報告値、基準範囲に変更はございません。


## 記

変更日： 2023年6月13日（火）報告分より

変更項目：AFP、FT4

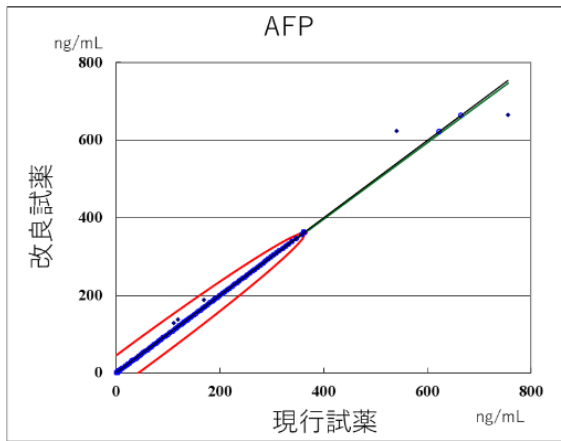

相関係数 $r =$	0.991
標準主軸回帰	$y = 0.99x + 1.61$

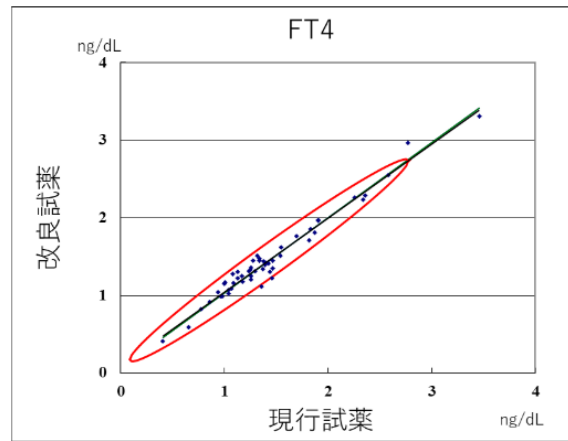

相関係数 $r =$	0.983
標準主軸回帰	$y = 0.97x + 0.07$

上記についてのお問い合わせは、検査部 サテライト検査室（内線7409）までお願い致します。