

平成26年6月25日

診療科長 医局長
病棟医長 外来医長
中央診療施設副部長 殿
看護部長 看護師長
事務部長

検査部 サテライト検査室

検査部回報No. 32

外注検査項目の測定試薬・基準値変更について

下記の項目は基準値が変更となりますのでお知らせします。

記


変更日：平成26年7月4日（金）受付分より

● HCV抗原（コア蛋白質）

（現試薬の販売中止に伴う高感度試薬への変更、基準値はメーカー設定値です。）

	旧	新
検査方法	CLEIA	CLIA
基準値	20未満 (fmol/L)	3.0未満 (fmol/L)
報告範囲	20~79900	3.0~19900

▶ 現試薬と新試薬の比較

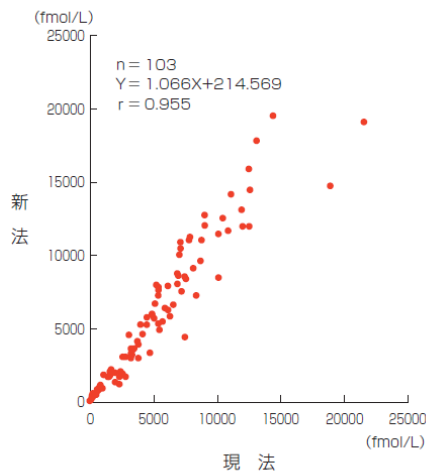

上記についてのお問い合わせは、サテライト検査室（内線7409）へお願い致します。