

2017年3月31日

診療科長 医局長
病棟医長 外来医長
中央診療施設副部長 殿
看護部長 看護師長
事務部長

検査部 サテライト検査室

検査部回報No. 40

外注検査項目 VMA精密・ホモバニール酸 (蓄尿および随時尿) 測定方法変更および報告 成分変更のお知らせ

外注検査項目 (VMA精密・ホモバニール酸) をより精度の高い、液体クロマトグラフィータンデム質量分析法 (LC-MS/MS) に変更いたします。本件に伴い、報告成分を変更いたします。(新たに赤字の報告成分を報告いたします)

記

変更日： 2017年4月1日 (土) 受付分より

【VMA 精密 (蓄尿)】

	新	旧
検査方法	LC-MS/MS	HPLC
報告成分	1日量 (mg/day) 濃度 (mg/L)	1日量 (mg/dl)

【VMA精密 (随時尿)】

	新	旧
検査方法	LC-MS/MS	HPLC
報告成分	クレアチニン補正值 (μ g/mg・Cre) 濃度 (mg/L) クレアチニン値 (mg/dL)	クレアチニン補正值 (μ g/mg・Cre)

【ホモバニール酸（蓄尿）】


	新	旧
検査方法	LC-MS/MS	HPLC
報告成分	1日量(mg/day) 濃度 (mg/L)	1日量(mg/ day)

【尿ホモバニール酸（随時尿）】


	新	旧
検査方法	LC-MS/MS	HPLC
報告成分	クレアチニン補正值 (μg/mg・Cre) 濃度 (mg/L) クレアチニン値 (mg/dL)	クレアチニン補正值 (μg/mg・Cre)

【新旧二法間の相関】

VMA

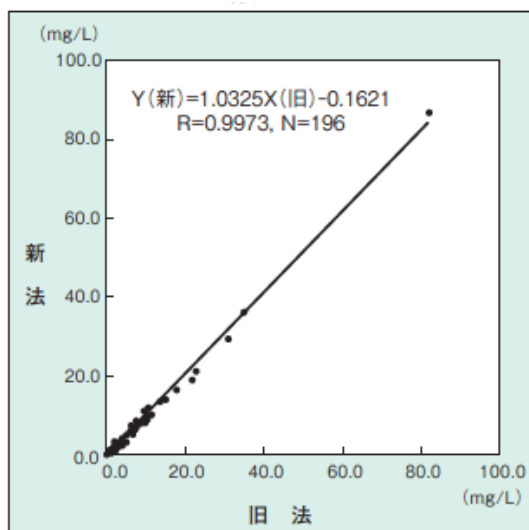

ホモバニール酸

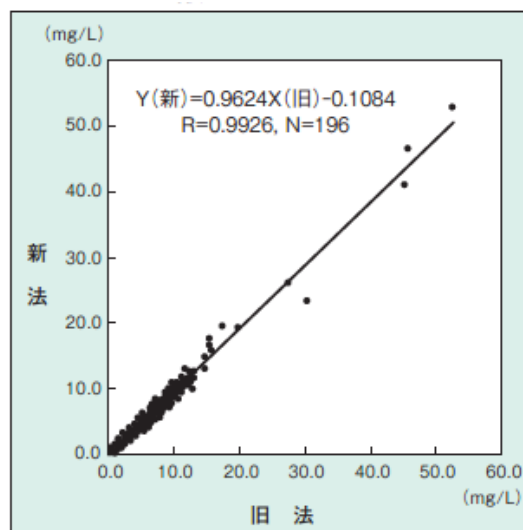

上記についてのお問い合わせは、サテライト検査室（内線7409）へお願い致します。