

2017年8月18日

診療科長 医局長
病棟医長 外来医長
中央診療施設副部長
看護部長 看護師長
事務部長 殿

検査部 免疫血清検査室

検査部回報 No.19

測定試薬・測定機器変更に伴う基準範囲の変更

および院内測定への移行について

検査機器の老朽化に伴い、測定機器を変更いたしましたので、下記項目の基準範囲が変更となります。それに伴いまして、MPO-ANCAおよびPR3-ANCAは外注検査から院内測定へ移行します。


記

変更日：2017年8月25日(金)16時以降受付分より


検査項目	現測定機器	現基準範囲	単位	新測定機器	新基準範囲	単位
sIL-2R	イムライズ2000 (SIEMENS) CLEIA	127-582	U/mL	STACIA (医学生物学研究所)	121-613	U/mL
PIVKA-II	ルミパルス G1200 (富士レピオ) CLEIA	<40	mAU/mL		<28	mAU/mL
KL-6		<500	U/mL		105.3-401.2	U/mL
MPO-ANCA	STACIA (LSIメディエンス) CLEIA	<3.5	U/mL		<3.5	U/mL
PR3-ANCA		<3.5	U/mL		<3.5	U/mL

***** 現行法との相関性（および一致率） *****


PIVKA - II

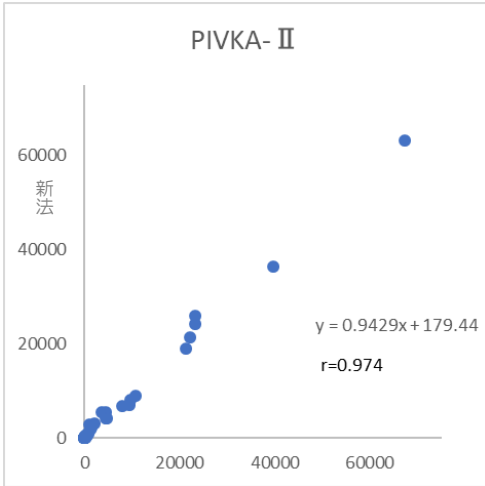

KL-6

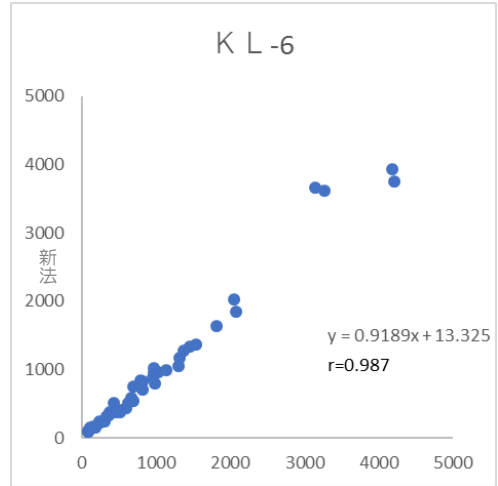

sIL-2R

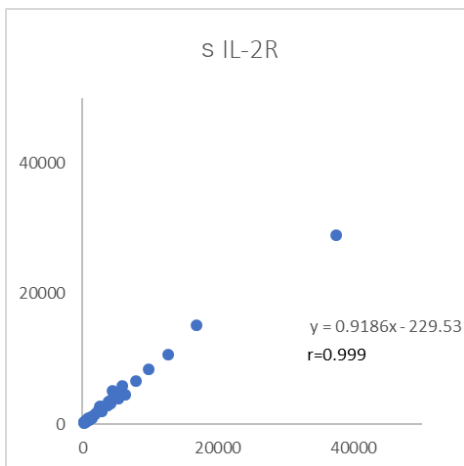

MPO-ANCA		現行法		
		+	-	
新法	+	24	0	24
	-	0	23	23
		24	23	47

一致率 100%

外注検査からの院内取り込みです。



同一試薬・機器を使用します。

PR3-ANCA		現行法		
		+	-	
新法	+	12	0	12
	-	0	24	24
		12	24	36

一致率 100%

外注検査からの院内取り込みです。

同一試薬・機器を使用します。

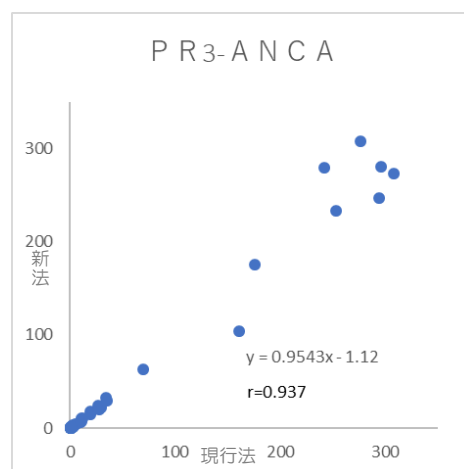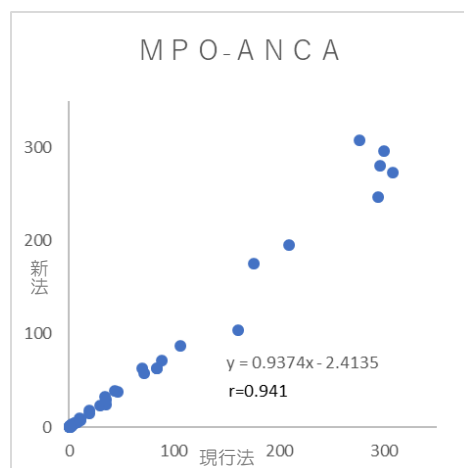

問い合わせは、検査部 免疫血清検査室（内線 7414）までお願いします。