

2018年6月14日

診療科長 医局長  
病棟医長 外来医長  
中央診療施設副部長  
看護部長 看護師長  
事務部長 殿

検査部 サテライト検査室

## 検査部回報 No. 15

### 血中・尿中グルコース検査の測定原理変更について

グルコース検査の測定原理が下表のように変更になります。基準範囲・測定範囲に変更は、ありません。


#### 記

変更日：2018年6月28日（木）16時以降の受付分より

検査項目：グルコース(ヘパリン血漿)

分析装置：グルコース：JCA-BM 6070

検査項目	旧測定原理	新測定原理
グルコース	酵素法 グルコキナーゼ (GlcK)	酵素法 ヘキソキナーゼ (HK)

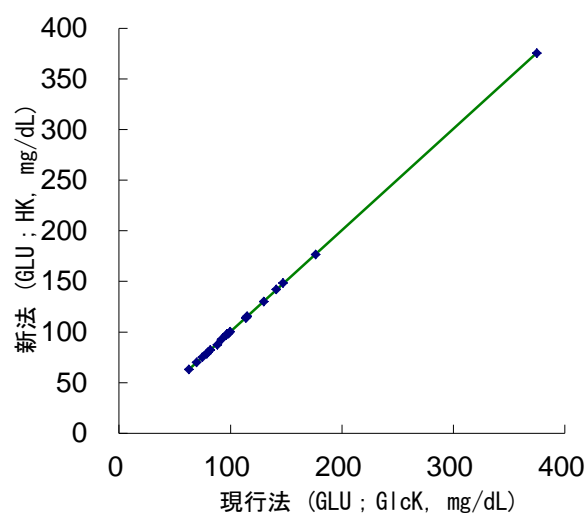

No.	GLU (mg/dL)	
	現行法	新法
1	96.9	98.1
2	92.0	92.7
3	129.7	130.1
4	113.8	114.1
5	81.9	82.3
6	74.7	75.0
7	88.1	87.3
8	114.9	115.3
9	176.3	176.4
10	99.8	100.4
11	98.3	98.5
12	78.7	79.0
13	78.7	78.6
14	113.7	114.3
15	115.0	115.6
16	79.8	80.1
17	69.6	70.1
18	96.3	97.1
19	374.7	375.4
20	147.1	148.3
21	62.6	63.2
22	141.0	142.0

問い合わせは、検査部 サテライト検査室(内線 7409、7411)までお願いします。