

平成30年12月5日

診療科長 医局長  
病棟医長 外来医長  
中央診療施設副部長 殿  
看護部長 看護師長  
事務部長

検査部 外注検査作業室

検査部回報No. 31

## 外注検査内容変更のお知らせ

BMLより、下記項目におきまして現行法の試薬販売中止に伴い、新試薬での測定となる旨の連絡がありました。測定原理、基準値、報告範囲が変更になりますので、ご案内させていただきます。

記


開始日：2018年12月7日（金）

変更項目：抗IA-2抗体

	現	新
測定原理	RIA 法	EIA 法
基準値 (U/mL)	0.4 未満	0.6 未満
報告範囲 (U/mL)	0.4 未満 ～50.0 以上	0.6 未満 ～30.0 以上

上記についてのお問い合わせは、外注検査作業室（内線7254）までお願い致します。

現行 RIA 法と新法との相関

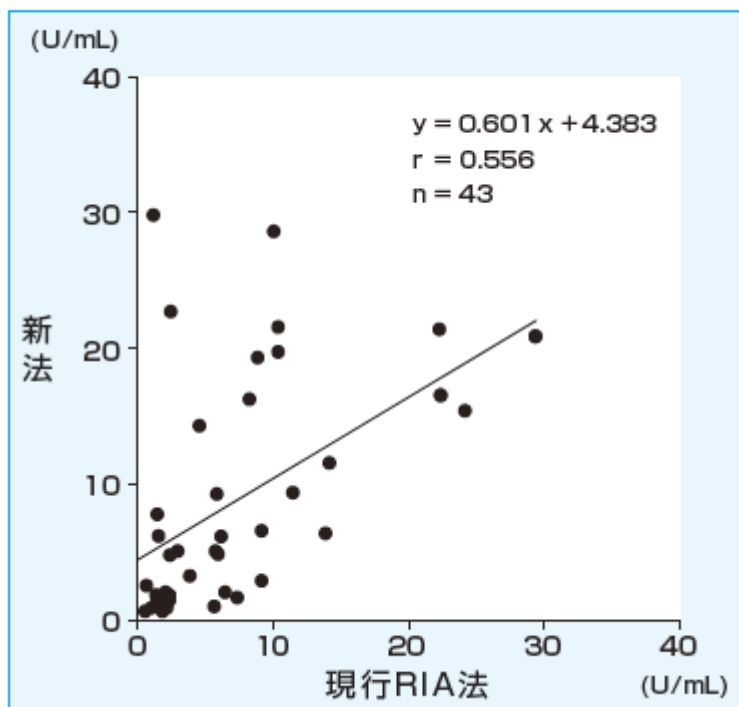

出典：BML Information No.2018-35 より