

平成31年2月14日

診療科長 医局長
病棟医長 外来医長
中央診療施設副部長 殿
看護部長 看護師長
事務部長

検査部 外注検査作業室

検査部回報No. 9

外注検査内容変更のお知らせ

BMLより下記項目におきまして、測定機器変更による検査内容変更のお知らせがありましたのでご案内いたします。


記

変更項目：リンパ球若幼化検査（分離培養法）PHA


リンパ球若幼化検査（分離培養法）Con-A

		旧	新	
PHA	測定原理	分離培養法による ^3H -サイミジン取り込み能	変更なし	
	基準値	PHA 刺激培養 (cpm)	なし	変更なし
		SI (PHA)	101.6~2643.8	147.5~1251.3
		無刺激培養 (cpm)	なし	変更なし
Con-A	測定原理	分離培養法による ^3H -サイミジン取り込み能	変更なし	
	基準値	Con-A 刺激培養 (cpm)	なし	変更なし
		SI (Con-A)	74.7~1793.2	38.1~385.5
		無刺激培養 (cpm)	なし	変更なし

▼現法と新法の比較 (PHA)

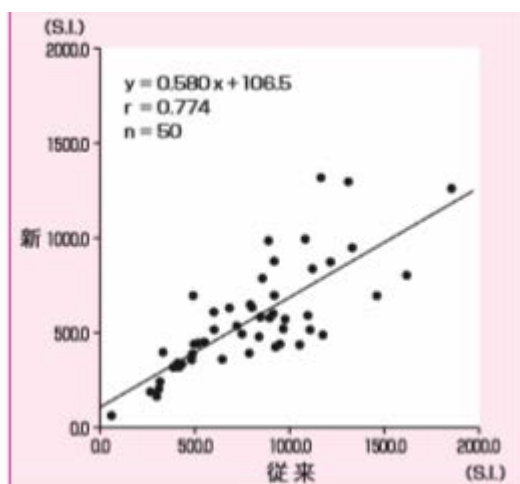

▼現法と新法の比較 (Con-A)

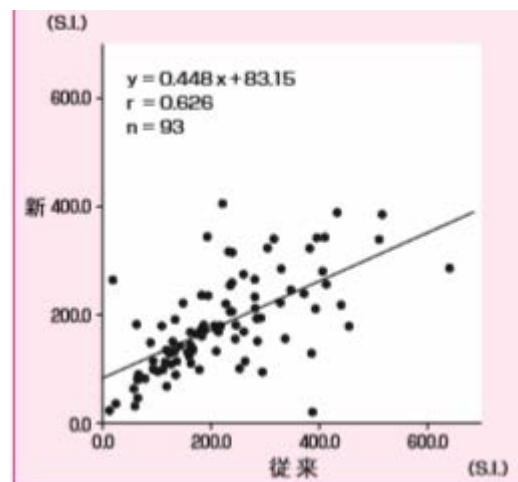

出典：BML Information No.2019-5

開始日：2019年4月1日（月）受付分より

上記についてのお問い合わせは、外注検査作業室（内線7254）までお願い致します。