校正証明書

大阪市此花区島屋4-1-131
アズワン株式会社
サービス営業部
フィールドサービスグループ

顧客名　長崎大学病院　薬剤部

品名	：温度・湿度データロガー	型式	：RTR-503L
製造番号	：52BC9B9B	製造者	：株式会社ティアンドデイ
校正日	：2022年4月11日	管理番号	：AKFS22-0183
顧客管理番号：①			

確認者

畑中

上記製品は、弊社の作業標準に従って校正が行われたことを証明します。
校正作業に使用した標準器/液は、日本電気計器検定所、日本品質保証機構などの公的校正機関またはNIST（National Institute of Standards and Technology）などの国際度量衡委員会に加盟している諸外国の公的校正機関にトレーサビリティが取れています。

[使用標準器]

品　名 形　式	製造者 製造番号	管理番号 有効期限
ハンディ湿度温度計	ヴァイサラ株式会社	MRI107
MI70/HMP77B	Z1120041/S2610187	2022年8月15日
白金デジタル温度計	株式会社　熱研	MRI31
SN-3400	340001520	2022年6月27日

Ver.3.0

アズワン株式会社

試験成績書

大阪市此花区島屋4-1-131
アズワン株式会社
サービス営業部
フィールドサービスグループ

品名	：温度・湿度データロガー	型式	：RTR-503L
製造番号	：52BC9B9B	製造者	：株式会社ティアンドデイ
校正日	：2022年4月11日	管理番号	：AKFS22-0183
環境温度	：25℃	校正者	：元原　茂雄
調整	：　あり ／ なし		

確認者
畑中

上記製品は、弊社の作業標準に従って校正が行われたことを証明します。
校正作業に使用した標準器/液は、日本電気計器検定所、日本品質保証機構などの公的校正機関またはNIST（National Institute of Standards and Technology）などの国際度量衡委員会に加盟している諸外国の公的校正機関にトレーサビリティが取れています。

[使用標準器]

品　名	製造者	管理番号
形　式	製造番号	有効期限
ハンディ湿度温度計	ヴァイサラ株式会社	MRI107
MI70/HMP77B	Z1120041/S2610187	2022年8月15日
白金デジタル温度計	株式会社　熱研	MRI31
SN-3400	340001520	2022年6月27日

[校正結果]

試験点	判定基準	指示値	判定
[温度]			
20.0℃	19.7℃ ～ 20.3℃	19.9℃	良
[湿度]			
25℃　50% RH	45% RH ～ 55% RH	48% RH	良
*総合判定			良

[備　考]

Ver.3.0

アズワン株式会社

管理番号: AKFS22-0183

トレーサビリティ体系図

大阪市此花区島屋4-1-131
アズワン株式会社
サービス営業部
フィールドサービスグループ

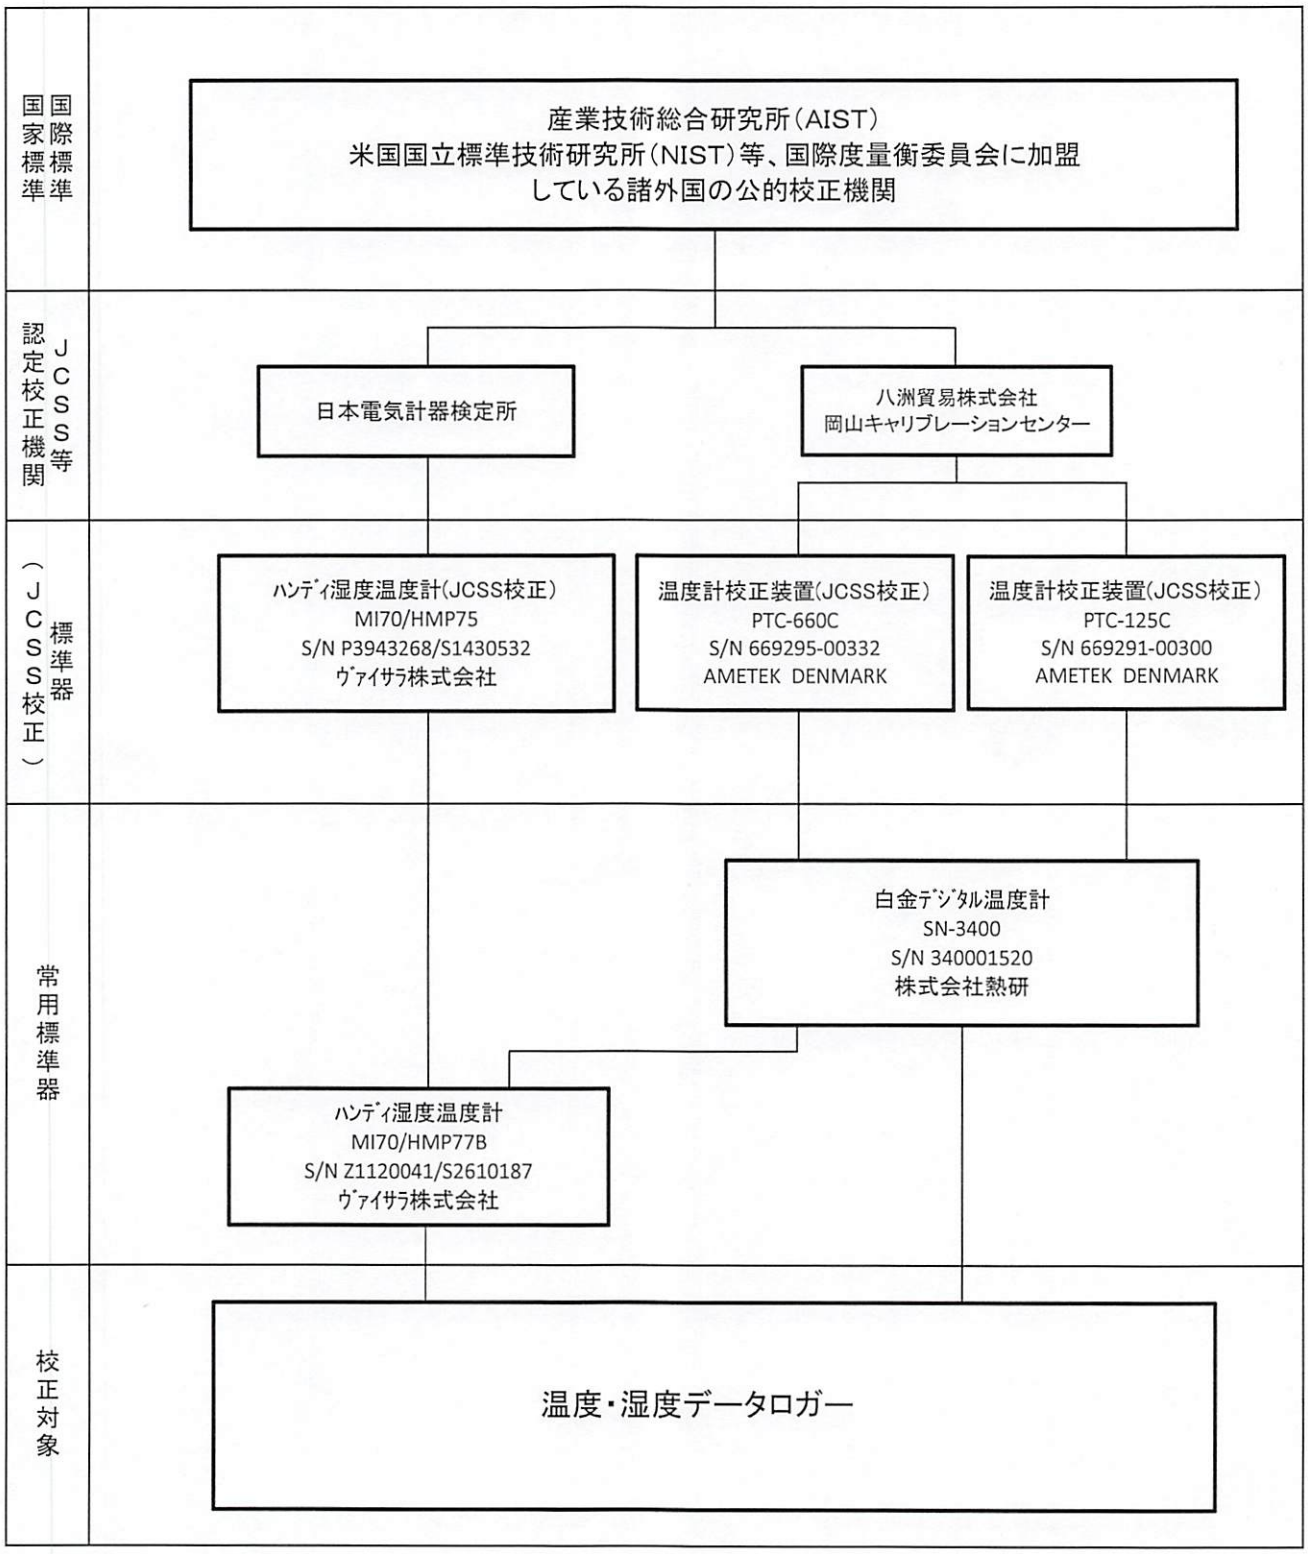

Ver.3.0

アズワン株式会社