

2026年5月28日

診療科長 医局長
病棟医長 外来医長
中央診療施設副部長
看護部長 看護師長
事務部長 殿


検査部 サテライト検査室
（生化学）

検査部回報 2026-No.20

「HCV 抗体」より「HCV 抗原・抗体」検査へ
変更のお知らせ

日頃より臨床検査業務へのご協力ありがとうございます。
現在、院内測定しております「HCV 抗体」の測定試薬変更についてお知らせします。

新試薬「エクルーシス試薬 HCV Duo」は、HCV 抗体に加え、HCV 抗原を同時に検出し、いずれも陽性であった場合は現在 HCV に感染していると判断できます。（ただし、HCV 抗原検査の検出感度は十分ではないため、HCV 抗体のみ陽性であった場合は、HCV RNA 検査を施行してください）。

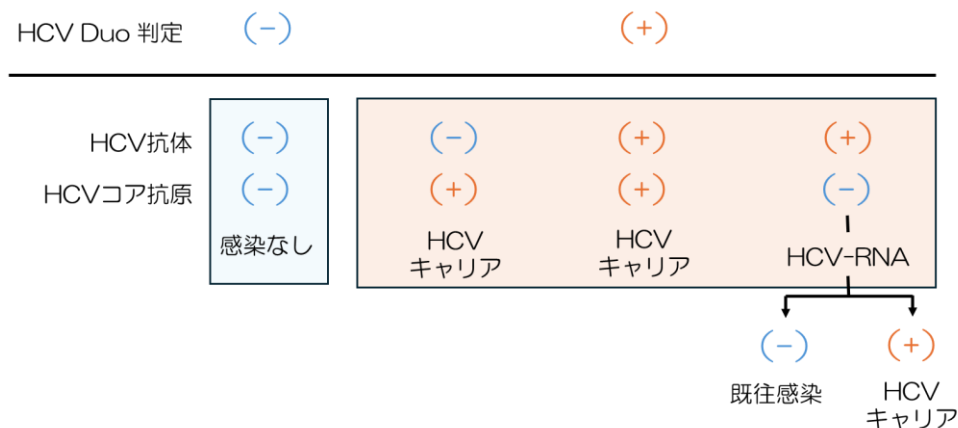

試薬変更に伴い、**必要検体量が多くなります**のでご注意ください。
検査依頼画面も変更されますので、**検査オーダーはコピーせず、新たにオーダー**してください。

運用開始後は、セット項目の変更（組みなおし）も併せてお願いいたします。

下記日時より測定を開始します。

記

変 更 日：2026年6月25日（木）より

検 査 項 目：HCV 抗原・抗体

	旧	新
測定項目	HCV 抗体	HCV 抗原・抗体
測定試薬	HCV Ab・アボット	エクルーシス試薬 HCV Duo
測定原理	化学発光免疫測定法 (CLIA) (定性)	電気化学発光免疫測定法 (ECLIA) (定性)
基準値	HCV 抗体 (-)	HCV 抗体 (-) HCV 抗原 (-) 総合判定 (-)
カットオフ値 (単位)	<1.0 (S/CO)	<1.0 (C.O.I)
検体	血清	血清
検体量	70 μ L	162 μ L
備考	保険点数：102 点	保険点数：102 点

<現行法との一致率>

最終判定

総合判定		HCV 抗体		合計
		(+)	(-)	
HCV 抗原・抗体 (HCV Duo)	(+)	66	1	67
	(-)	13	59	72
合計		79	60	139

お問い合わせは、検査部 サテライト検査室（内線 7409）までお願いします。