


* error. 03-Dec-2024. J.H

電池交換に実施された一時的にDP-10と冷蔵庫から取り出している。
 同冷蔵庫には温度DP-10と入った温度管理している
 DP-10の温度変動は、実験室に温度変動は無い。
 ↓
 昇

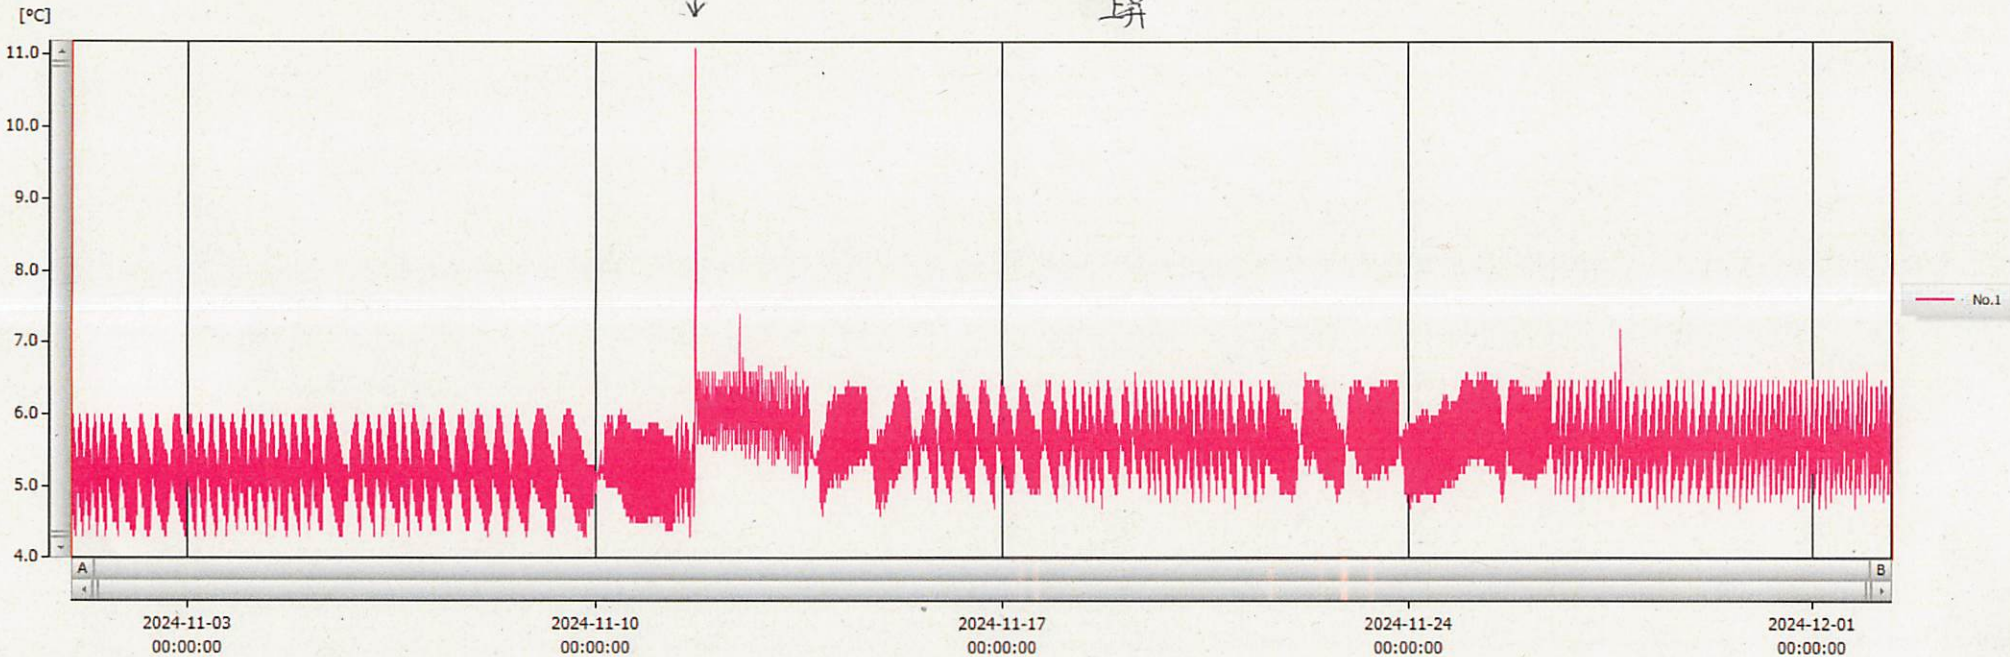

表示範囲 2024-10-31 23:42:00 - 2024-12-02 09:28:00

計算範囲 2024-10-31 23:42:00 - 2024-12-02 09:28:00

No.	チャンネル名	記録間隔	データ数	単位	最大値	最小値	平均値
No.1	9	15 min.	3016	°C	11.1	4.3	5.5